




LIITE: Tutkimustuloksia kuvaajina

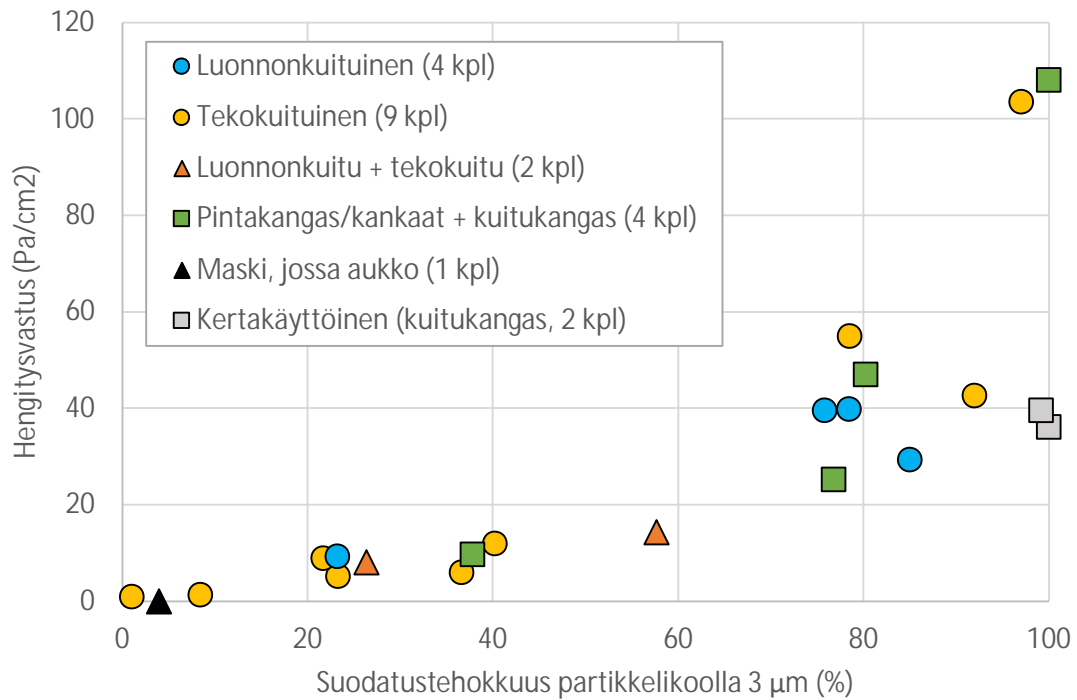

Kuva 1: Tulosten perusteella pestävien maskien osalta ei voitu eritellä mitään tiettyä materiaalia tai rakennetta, joka olisi merkittävästi muita parempi. Kuvassa on esitetty testattujen maskien suodatustehokkuuden ja hengitysvastuksen arvot eri materiaaleilla ja rakenteilla.

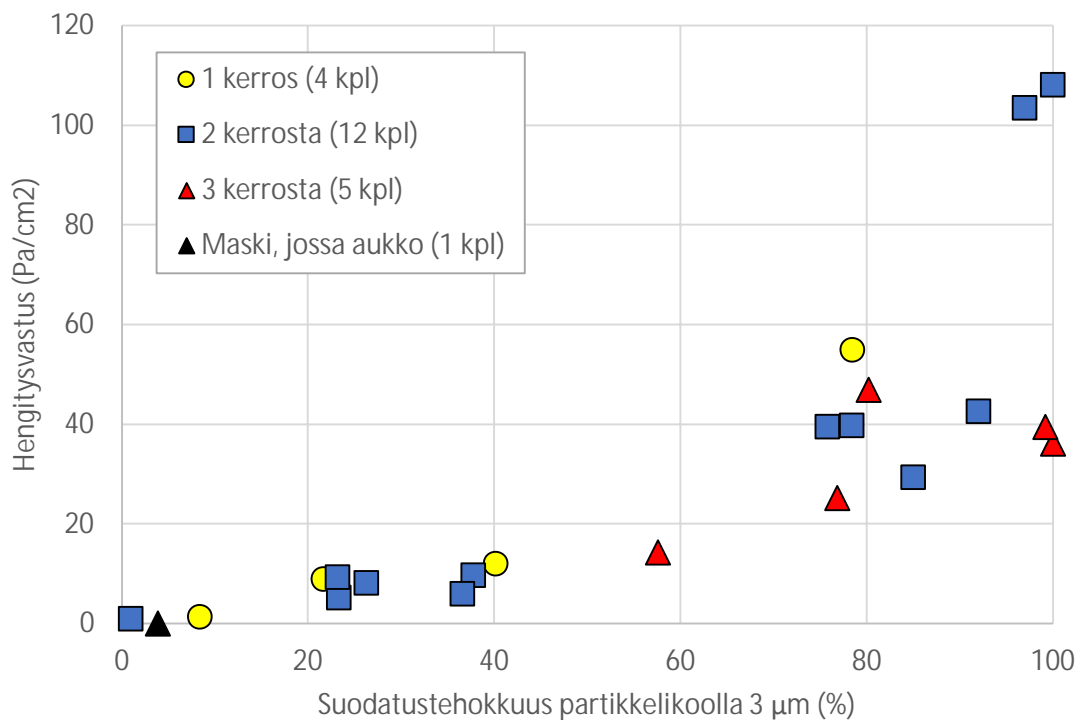

Kuva 2: Kuvassa on esitetty tutkittujen maskien suodatustehokkuuden ja hengitysvastuksen arvot eri kerrosmäärillä.

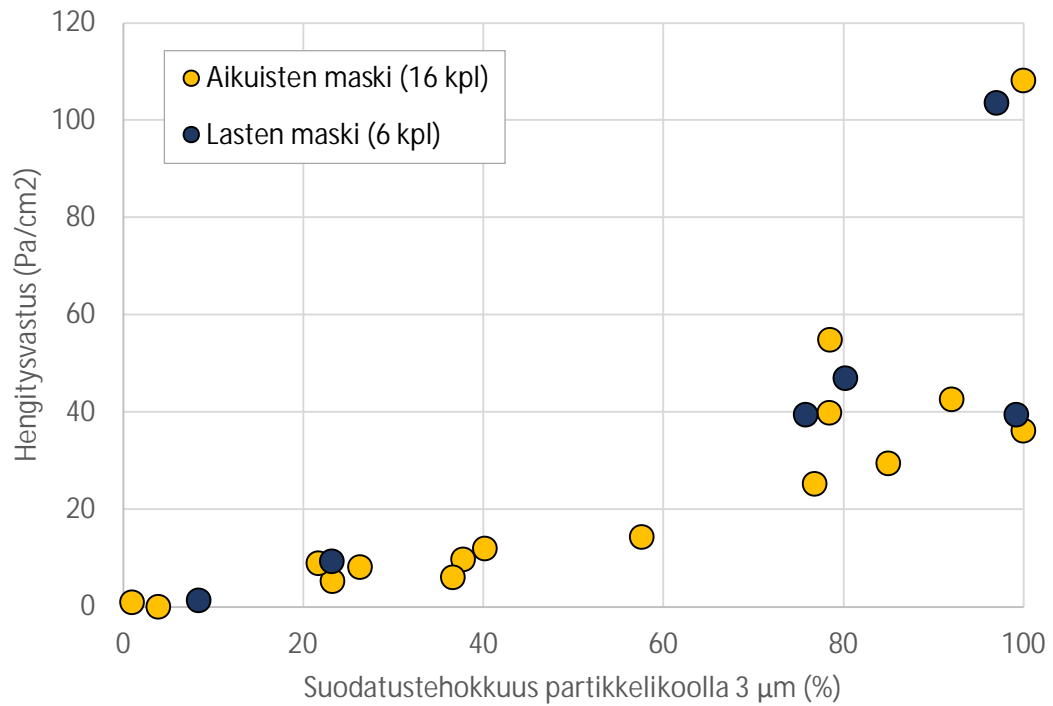

Kuva 3: Tulosten mukaan tutkittujen lasten maskien hengittävyys- ja suodatavuusominaisuudet eivät poikenneet aikuisten maskeista. Kuvassa on esitetty tutkittujen lasten ja aikuisten maskien hengitysvastuksen ja suodatustehokkuuden arvot.